




ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 45 del 08/02/2017

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico I.M. Medical S.a.s., offerente nella procedura di Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia con opzione d'acquisto, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z851BD905D).





ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico I.M. Medical S.a.s., offerente nella procedura di Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necropsopia con opzione d'acquisto, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z851BD905D).

Si sottopone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi la seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con Determinazione n. 146 del 08/09/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio della procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, commi 1 e da 4 a 7 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 (di seguito semplicemente "Regolamento") volta all'affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necropsopia con opzione d'acquisto di durata annuale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto"), da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo.

Con il medesimo provvedimento è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4, comma 3 del Regolamento, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per n. 5 giorni solari consecutivi.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori economici:

- Metalarredinox S.r.l.;
- I. M. Medical S.a.s..

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 17/11/2016, ai citati operatori economici, la lettera di invito (allegata alla RdO n. 1411073), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Metalarredinox S.r.l.;
- I. M. Medical S.a.s..

Esaminata la fase di verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa, con nota del RUP datata 19/01/2017 agli atti è stato nominato esperto deputato al supporto nella valutazione di idoneità tecnica delle offerte il Dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT2 dell'Istituto.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 24/01/2016, in seguito all'esame della documentazione tecnica, è stata rilevata, con riferimento all'offerta presentata dall'operatore economico I.M. Medical S.a.s., l'inidoneità tecnica della stessa in quanto: "*(...) la documentazione fornita da questa Ditta risulta lacunosa e insufficiente a verificare la corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche. L'offerta è basata in gran parte su immagini dichiarate "indicative" dallo stesso offerente. Soprattutto, però, risulta inadeguata l'offerta relativa al tavolo autoptico: la ditta I.M.Medical s.a.s. offre un tavolo autoptico dedicato ai grandi animali, con portata di 1000 Kg, larghezza 1000 cm, ripiano forato ed altre caratteristiche non conformi alle specifiche*". Il dettaglio della valutazione dell'esperto è riportata nelle tabelle 1 - 3 allegato al verbale di idoneità tecnica, cui si rinvia.

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel già menzionato verbale cui si fa espresso rinvio, nel corso della seduta riservata del 26/01/2017, come emerge dal relativo verbale di cui si allega copia (Allegato2), il RUP, preso atto del giudizio espresso dall'esperto, propone l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione *de qua non "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"* citate dalle summenzionate disposizioni normative e regolamentari.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi quanto segue:

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali delle sedute del 24/01/2017 e del 26/01/2017, allegati in copia al presente provvedimento (Allegati 1 e 2), l'esclusione dell'operatore economico I.M. Medical S.a.s. dalla procedura in parola;
2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere la comunicazione di avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione *de qua "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"*;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali delle sedute del 24/01/2017 e del 26/01/2017, allegati in copia al presente provvedimento (Allegati 1 e 2), l'esclusione dell'operatore economico I.M. Medical S.a.s. dalla procedura in parola;
2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere la comunicazione di avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione *de qua* "*all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali*";
4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della procedura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Dott. Davide Violato

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta di determinazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa su Finanziamento istituzionale


Finanziamento vincolato

Altri finanziamenti

Non comporta spesa

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget





Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia con opzione d'acquisto, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

CIG: Z851BD905D

VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 24/01/2017, alle ore 8.30', presso la sede territoriale di Villorba, il sottoscritto Dott. Fabrizio Agnoletti, Dirigente Veterinario presso la SCT2 dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP agli atti, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dall'offerente, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dalla Ditta Metalarredinox srl
- tecnicamente non idonea l'offerta presentata dalla Ditta I.M.Medical s.a.s. In particolare la documentazione fornita da questa Ditta risulta lacunosa e insufficiente a verificare la corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche. L'offerta è basata in gran parte su immagini dichiarate "indicative" dallo stesso offerente. Soprattutto, però, risulta inadeguata l'offerta relativa al tavolo autoptico: la ditta I.M.Medical s.a.s. offre un tavolo autoptico dedicato ai grandi animali, con portata di 1000 Kg, larghezza 1000 mm, ripiano forato ed altre caratteristiche non conformi alle specifiche. Maggiori dettagli su queste valutazioni sono riportati nella successive tabelle 1-3.

| Tabella 1. SPECIFICHE TAVOLO NECROSCOPICO | RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE | |
|--|-----------------------------|--|
| | Metalarredinox | I.M.Medical s.a.s. |
| Materiale: acciaio inox AISI 304 finitura lucida | SI | Non dichiarato il materiale né il tipo di finitura |
| Portata massima 400 Kg | SI | La ditta fornisce l'immagine di un tavolo autoptico per grandi animali con portata di 1000 kg, non corrispondente alle specifiche richieste. |
| Dimensioni: lunghezza: 2000 mm, larghezza: 800 mm, altezza variabile: 750-1050 mm. | SI | Non equivalente alle specifiche, in particolare per la larghezza pari a 1000 mm |

| | | |
|--|----|---|
| Piano superiore monoblocco sagomato in acciaio inox AISI 316, finitura lucida e spessore 15/10 mm, con bordatura perimetrale di contenimento priva di spigoli vivi, altezza 50 mm, inclinata verso lo scarico centrale. | SI | Non equivalente alle specifiche |
| Al centro del ripiano sarà posizionato foro di scarico (diametro 60 mm) chiudibile con idoneo tappo in acciaio inox. Inferiormente lo scarico continuerà con un tubo inox di uguale diametro e lunghezza di 15 cm al quale dovrà essere possibile raccordare un tubo in gomma fissato con fascette inox. | SI | Non dichiarato e non desumibile dall'immagine fornita dalla ditta |
| Ruote girevoli con freno, diametro 125 mm, in nylon pesante e portata 250 Kg cad, con supporti in acciaio inox. | SI | Non equivalente alle specifiche, per quanto desumibile dalla documentazione fornita |
| Regolazione dell'altezza (escursione massima 300 mm) mediante centralina elettronica. L'operatore dovrà regolare l'altezza del tavolo mediante manipolatore a leva di facile accesso ed elevata ergonomia. | SI | Non dichiarato e non desumibile dall'immagine fornita dalla ditta |
| Pannello di comando con centralino dei dispositivi elettrici e interruttore magnetico termico e differenziale, con presa elettrica di servizio 230 V 16 A e comando a leva per regolazione altezza del piano di lavoro. | SI | Non dichiarato e non desumibile dall'immagine fornita dalla ditta |
| La struttura tubolare di supporto situata inferiormente a livello delle ruote, dovrà essere rivestita da lamiera di acciaio inox, spessore 10/10 mm, ripiegata fino a bordo ruote, in modo da ottenere una seconda superficie di appoggio di adeguata rigidità. | SI | Non equivalente alle specifiche |
| Dispositivi elettrici con grado di protezione IP65, e realizzazione conforme alle norme di riferimento. | SI | Non dichiarato e non desumibile dall'immagine fornita dalla ditta |
| Le lamiere non dovranno presentare spigoli vivi, in modo da ridurre l'impatto in caso di urto accidentale | SI | Non dichiarato e non desumibile dall'immagine fornita dalla ditta |

| Tabella 2. Specifiche carrello con anta ribaltabile | Rispondenza alle specifiche | |
|---|-----------------------------|--|
| | Metalarredinox | I.M.Medical s.a.s. |
| Materiale: acciaio inox AISI 304 finitura lucida | SI | Non dichiarato il materiale né il tipo di finitura |
| Portata massima 250 Kg | SI | Non dichiarata |
| Dimensioni: larghezza cm 65, lunghezza cm 1000, altezza complessiva (comprensiva di ruote): 95 cm | SI | Nelle specifiche è richiesta un'altezza della vasca di 40 cm, non corrispondente all'offerta |
| Il carrello sarà costituito da una struttura tubolare (tubi a sezione quadra o rettangolare), spessore 15/10 mm, di altezza 45 cm (fino al perno ruota), sulla quale poggerà un parallelepipedo inox, senza copertura, con pareti in lamiera inox spessore 15/10 mm, alte 40 cm | SI | L'immagine indicativa fornita dalla ditta non sembra corrispondere alle specifiche |
| Fondo in lamiera inox forata, spessore 20/10 mm, per permettere il lavaggio e il deflusso dell'acqua. | SI | Non è dichiarato lo spessore della lamiera |
| Parete laterale ribaltabile | SI | Non dichiarato |
| n. 4 ruote con camera d'aria, diametro 20 cm, due con freno. Supporti delle ruote in acciaio inox. | SI | Non è dichiarata la tipologia di ruote né il materiale dei loro supporti |
| Maniglione di spinta in tubolare inox (diametro 30 mm), di dimensioni tali da garantire uno spazio di 25 cm fra parete | SI | L'immagine indicativa fornita dalla ditta non |


| | | |
|---|----|---|
| laterale del carrello e bordo interno del maniglione di spinta. | | consente di verificare la rispondenza alle specifiche |
| La parete ribaltabile dovrà fissarsi alle pareti laterali corte con appositi ganci di fissaggio o tramite sistemi magnetici, purchè funzionali anche in presenza di acqua, inoltre dovrà essere provvista di maniglia per l'apertura. | SI | Non dichiarato dalla ditta |


| Tabella 3. Specifiche carrelli trasporto a sviluppo verticale | Rispondenza alle specifiche | |
|---|-----------------------------|---|
| | Metalarredinox | I.M.Medical s.a.s. |
| Materiale: acciaio inox AISI 304 finitura lucida | SI | Non dichiarato il materiale né il tipo di finitura |
| Dimensioni: altezza cm 80, comprensiva di ruote e calcolata fino al bordo superiore del cesto in lamiera Cesto in lamiera a sezione quadra (cm 40 x 40), con pareti in lamiera alte 66 cm, spessore 15/10 mm, con angoli arrotondati | SI | Non è dichiarato lo spessore della lamiera. Dall'immagine indicativa fornita dalla ditta si desume la presenza di spigoli vivi, mentre nei requisiti minimi sono stati richiesti bordi arrotondati (internamente ed esternamente) |
| Bordo superiore del cesto ripiegato | SI | SI |
| Fondo forato (fori rotondi), spessore 20/10 mm, per permettere il lavaggio e il deflusso dell'acqua, | SI | SI |
| n. 4 ruote in gomma diametro 125 mm, due con freno, con supporti in acciaio inox | SI | Non è specificato il materiale dei supporti |
| Portata massima: 150 Kg | SI | Non dichiarata |
| Maniglione di spinta sagomato, realizzato in tubolare inox diametro 30 mm, raccordato o saldato in almeno 4 punti al cesto inox. | SI | SI |
| Parte superiore del maniglione ripiegata in direzione dell'operatore in modo da facilitarne la spinta. | SI | Nell'immagine fornita dalla ditta la sagomatura del maniglione, che deve sporgere di 20 cm rispetto al bordo superiore del cesto, non sembra corrispondente alle specifiche |

La seduta si chiude alle ore 12.20'.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Direttore di SCT2
Dott. Fabrizio Agnoletti.

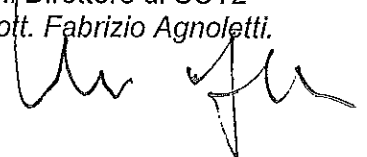





ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia con opzione d'acquisto, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

CIG: Z851BD905D

VERBALE DI ESCLUSIONE

In data odierna 26/01/2017 alle ore 12:00 la Dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto"), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d'atto del giudizio espresso dall'esperto deputato alla valutazione dell'idoneità tecnica delle offerte presentate nella procedura in oggetto ed all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti:

- la Dott.ssa Marzia Trivellato, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- la Dott.ssa Emma Boresi, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 24/01/2017, nel corso della quale l'esperto ha giudicato:

"- tecnicamente idonea l'offerta presentata dalla Ditta Metalarredinox Srl;

- tecnicamente non idonea l'offerta presentata dalla Ditta I.M.Medical S.a.s. In particolare la documentazione fornita da questa Ditta risulta lacunosa e insufficiente a verificare la corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche. L'offerta è basata in gran parte su immagini dichiarate "indicative" dallo stesso offerente. Soprattutto, però, risulta inadeguata l'offerta relativa al tavolo autoptico: la ditta I.M.Medical s.a.s. offre un tavolo autoptico dedicato ai grandi animali, con portata di 1000 Kg, larghezza 1000 cm, ripiano forato ed altre caratteristiche non conformi alle specifiche". Il dettaglio della valutazione è riportato nelle tabelle 1 - 3 allegate al Verbale di idoneità tecnica, conservato agli atti del Servizio.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette l'offerta della concorrente Metalarredinox S.r.l. alla fase successiva della procedura e dichiara l'esclusione dell'offerta della concorrente I.M. Medical S.r.l. disponendo affinché si proceda a darne comunicazione con le modalità ed entro i termini previsti per legge, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Si precisa che il presente verbale non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 17 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016, conseguendo l'esclusione *de qua non "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"* citate dalla summenzionate disposizioni normative e regolamentari.

10

mt

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento Valentina Orsini

Dott.ssa Marzia Trivellato - testimone e segretario verbalizzante Marzia Trivellato

Dott.ssa Emma Boresi – testimone Emma Boresi